

Informations kits de prélèvement

KIT ALUMINIUM

Uniquement pour les huiles frigorigères

**IL N'EST PLUS NÉCESSAIRE D'ATTENDRE LE DÉGAZAGE
DE L'HUILE POUR FERMER LE FLACON !**


Ce flacon a été testé et approuvé par notre service qualité. Ce dernier vous permet de limiter au maximum la prise d'humidité de vos échantillons grâce à la suppression de l'étape de dégazage des huiles.

Ce flacon est adapté à une pressurisation de l'ordre de 2 Bar à 50°C.



- Un flacon 100mL en aluminium avec bouchon fileté
- Une étiquette information
- Une enveloppe ou un carton pour le retour

Retour du/des échantillon(s) par le transporteur de votre choix, à vos frais.

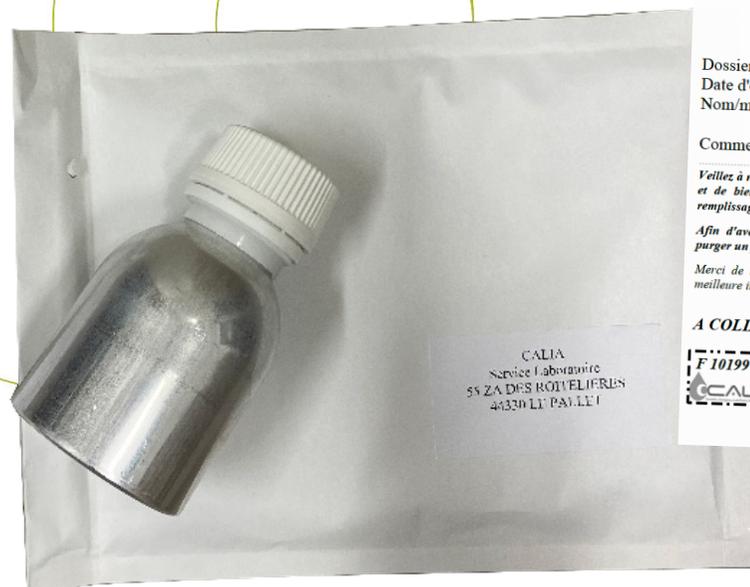

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter : 06 69 94 94 60 ou vente@calia-analyse.com

Société :
Implantation (ville) :
N° ETIQUETTE : F10199
Nom(s) et/ou E-mail(s) (résultats) :
Nom de chantier :
Nom/Référence du compresseur :
Nombre H ou Kms du matériel :
Type de Compresseur : VIS - PISTON - Autre :
Gaz / Réfrigérant utilisé :
Prélèvement ou vidange ? - Date intervention : / /
Point de prélèvement :
Marque et Nom de l'huile :
ou Marque et Nom du glycol :
Viscosité/grade de l'huile :
Nombre H ou Kms de l'huile :
Volume du carter / Réservoir :
Référence dernière analyse :
Commentaire, problématique rencontrée (incident, appoint...) :

N° ETIQUETTE : F10199

Dossier :
Date d'envoi au laboratoire :
Nom/marque du matériel :

Commentaire :

Veillez à nous faire parvenir les échantillons au plus tôt après prélèvement et de bien les fermer jusqu'au click de sécurité tout de suite après remplissage, pour limiter la prise d'humidité.

Afin d'avoir des résultats représentatifs de votre installation, veillez à purger un peu le point de prélèvement et à éviter le fond de bouteille.

Merci de remplir au maximum les informations de l'étiquette, pour une meilleure interprétation des résultats. Merci de votre compréhension.
Pour plus d'informations : www.calia-analyse.com

A COLLER SUR LE FLACON



KIT CLASSIQUE

A RETOURNER AU LABORATOIRE 55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 94 30 03
VENTE : 06 69 94 94 60

Société :

Implantation (ville) :

N° ETIQUETTE : G10199

Nom(s) et/ou E-mail(s) (résultats) :

Nom de chantier ou client :

Type d'installation :

A quoi sert-elle ?

Nom/Marque :

Nombre H ou Kms :

Prélèvement ou vidange ? - Date intervention :

Point de prélèvement :

Type d'organe contrôlé : Réducteurs - Moteurs - Boite/Pont - Hydraulique -
Compresseur - Carburant - Liquide de refroidissement - Autre :

Séquence d'analyse souhaitée : Séq 1 ou Séq 2

Marque et Nom du lubrifiant :

Viscosité/grade du lubrifiant :

Nombre H ou Kms du lubrifiant :

Volume du carter / Réservoir / bache :

Commentaire, problématique rencontrée (incident, appoint...) :

A CONSERVER PAR LE CLIENT



55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 04 30 03
VENTE : 06 69 94 94 60

N° ETIQUETTE : G10199

Dossier :

Date d'envoi au laboratoire :

Nom/marque du matériel :

Commentaire :

Afin d'avoir des résultats représentatifs de votre installation, veuillez à purger un peu le point de prélèvement et à éviter le fond de réservoir.

Merçi de remplir au maximum les informations de l'étiquette, pour une meilleure interprétation des résultats. Merçi de votre compréhension.
Pour plus d'informations : www.calia-analyse.com

A COLLER SUR LE FLACON




- Un flacon tout fluide 100mL ou 250mL / Flacon carburant 500mL
 - Une étiquette information
 - Une enveloppe ou un carton de retour
- Retour du/des échantillon(s) par le transporteur de votre choix, à vos frais.

KIT SERINGUE



- Un flacon 100mL
- Une étiquette information
- Une seringue de prélèvement à usage unique
- 1m de flexible
- Une enveloppe ou un carton de retour

Retour du/des échantillon(s) par le transporteur de votre choix, à vos frais.

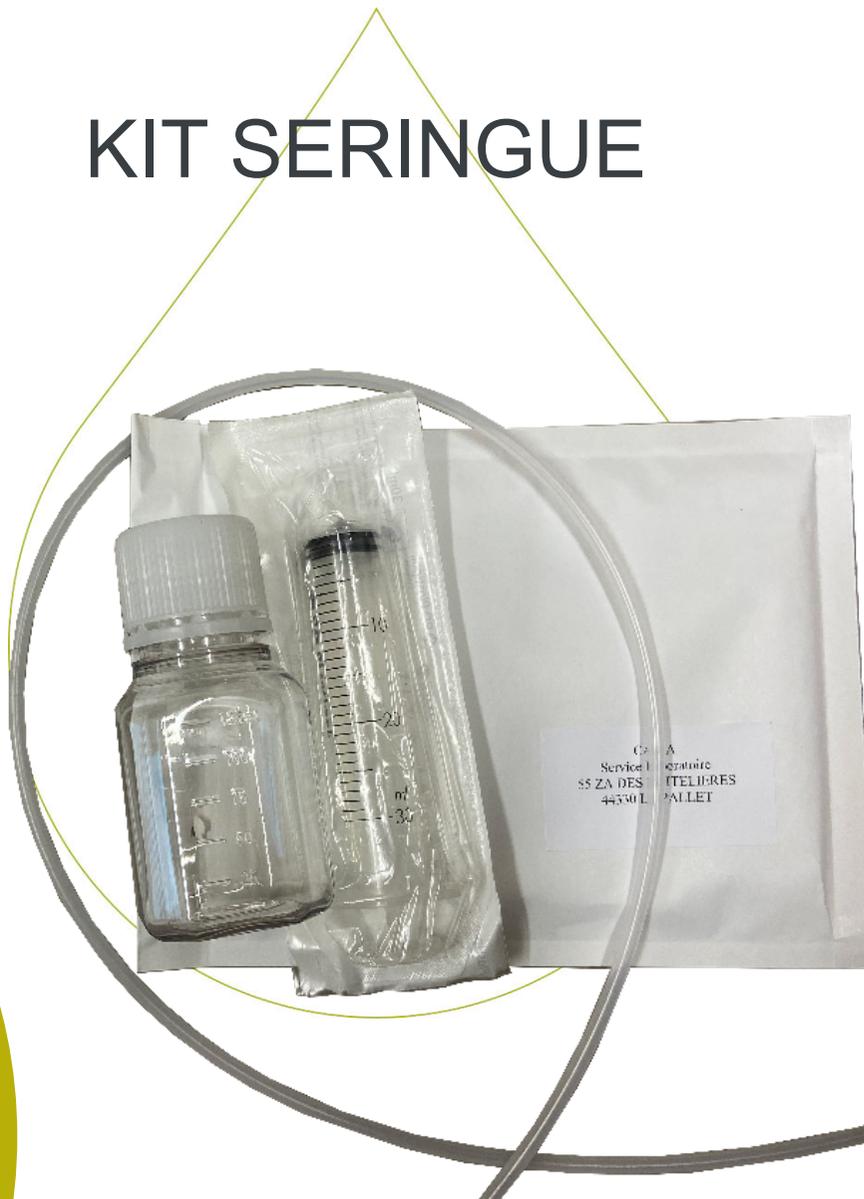

A RETOURNER AU LABORATOIRE 55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 04 30 03
VENTE : 06 69 94 94 60

CALIA
Conseils - Analyses - Lubrifiants Industriels - Automotives

Société :

Implantation (ville) :

N° ETIQUETTE : M10199

Nom(s) et/ou E-mail(s) (résultats) :

N° Immatriculation :

Nom/Marque du véhicule :

Nombre H ou Kms du matériel :

Vidange : Date intervention :

Prélèvement : Date intervention :

Point de prélèvement : - - - - -

Type d'énergie : Essence - Diesel - Gaz - Autre :

Type d'organe contrôlé : Moteurs - Boite/Pont - Carburant - Liquide de refroidissement - Autre :

Séquence d'analyse souhaitée : Séq 1 ou Séq 2

Marque et Nom de l'huile :

Viscosité/grade de l'huile :

Nombre H ou Kms de l'huile :

Commentaire, problématique rencontrée (incident, appoint...) :

A CONSERVER PAR LE CLIENT

CALIA
Conseils - Analyses - Lubrifiants Industriels - Automotives

55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 04 30 03
VENTE : 06 69 94 94 60

N° ETIQUETTE : M10199

Dossier :

Date d'envoi au laboratoire :

Nom/marque du matériel :

Commentaire :

Afin d'avoir des résultats représentatifs de votre installation, veillez à purger un peu le point de prélèvement et à éviter le fond de réservoir.

Merçi de remplir au maximum les informations de l'étiquette, pour une meilleure interprétation des résultats. Merçi de votre compréhension.

Pour plus d'informations : www.calia-analyse.com

A COLLER SUR LE FLACON



Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter : 06 69 94 94 60 ou vente@calia-analyse.com

A RETOURNER AU LABORATOIRE 55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 04 30 03
VENTE : 06 69 94 94 60

Société : _____
Implantation (ville) : _____
N° ETIQUETTE : H10199

Nom(s) et/ou E-mail(s) (résultats) : _____
Nom de chantier : _____
Nom/ Marque de l'installation : _____
Nombre H ou Kms : _____
Prélèvement ou vidange ? - Date intervention : _____
Point de prélèvement : _____
Distribution : Servo valve - Proportionnelle - Autre : _____
Actionneur : Vérin - Moteur - Multiplicateur - Autre : _____
Classe de pollution limite souhaitée AS4059 ou ISO : _____
Porosité du système de filtration : _____ µm
Séquence d'analyse souhaitée : Séq 1 ou Séq 2
Marque et Nom de l'huile : _____
Viscosité/grade de l'huile : _____
Nombre H ou Kms de l'huile : _____
Volume du carter / Réservoir : _____
Référence dernière analyse : _____
Commentaire, problématique rencontrée (incident, appoint...) : _____

A CONSERVER PAR LE CLIENT

CALIA 55 ZA LES ROITELIERES
44330 LE PALLET
LABO : 02 40 04 30 03
COMMERCE : 06 69 94 94

N° ETIQUETTE : H10199

Dossier : _____
Date d'envoi au laboratoire : _____
Nom/marque du matériel : _____
Commentaire : _____

Afin d'avoir des résultats représentatifs de votre installation, veillez à purger un peu le point de prélèvement et à éviter le fond de réservoir.
Merci de remplir au maximum les informations de l'étiquette, pour une meilleure interprétation des résultats. Merci de votre compréhension.
Pour plus d'informations : www.calia-analyse.com

A COLLER SUR LE FLACON




KIT MALLETTE



- Un flacon mallette 100mL
- Une étiquette information
- 1m de flexible
- Une enveloppe ou un carton de retour

Retour du/des échantillon(s) par le transporteur de votre choix, à vos frais.

KIT RETOUR T

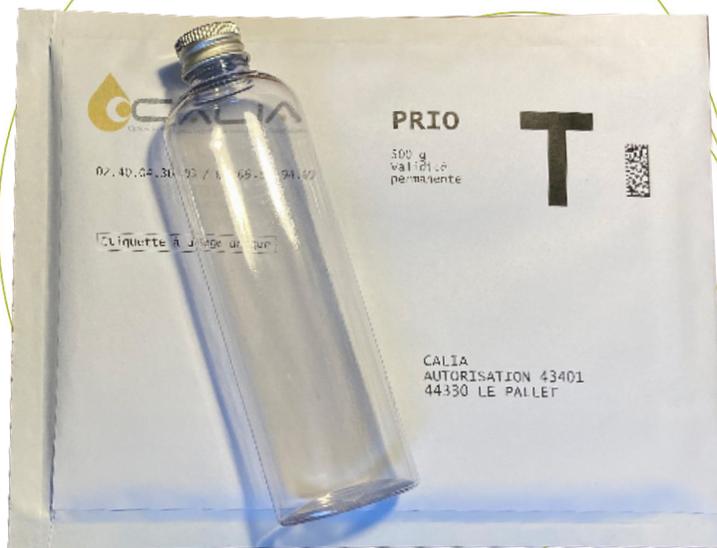

- Un flacon plat 100mL
- Une étiquette information
- Une enveloppe pré affranchie retour boîte postale

Retour compris avec l'achat du kit

A RETOURNER AU LABORATOIRE
CALIA
 Conseils «Analyses» Lubrifiants Industriels «Automotives»
 55 ZA LES ROITELIERES
 44330 LE PALLET
 LABO : 02 40 04 30 03
 VENTE : 06 69 94 94 60

Société :

Implantation (ville) :

N° ETIQUETTE : G10199

Nom(s) et/ou E-mail(s) (résultats) :

Nom de chantier ou client :

Type d'installation :

A quoi sert-elle ?

Nom/Marque :

Nombre H ou Kms :

Prélèvement ou vidange ? - Date intervention : / /

Point de prélèvement :

Type d'organe contrôlé : Réducteurs - Moteurs - Boite/Pont - Hydraulique -
 Compresseur - Carburant - Liquide de refroidissement - Autre :
 Séquence d'analyse souhaitée : Séq 1 ou Séq 2

Marque et Nom du lubrifiant :

Viscosité/grade du lubrifiant :

Nombre H ou Kms du lubrifiant :

Volume du carter / Réservoir / bache :

Commentaire, problématique rencontrée (incident, appoint...) :

A CONSERVER PAR LE CLIENT

CALIA
 Conseils «Analyses» Lubrifiants Industriels «Automotives»

55 ZA LES ROITELIERES
 44330 LE PALLET
 LABO : 02 40 04 30 03
 VENTE : 06 69 94 94 60

N° ETIQUETTE : G10199

Dossier :

Date d'envoi au laboratoire :

Nom/marque du matériel :

Commentaire :

Afin d'avoir des résultats représentatifs de votre installation, veillez à purger un peu le point de prélèvement et à éviter le fond de réservoir.

Merci de remplir au maximum les informations de l'étiquette, pour une meilleure interprétation des résultats. Merci de votre compréhension.

Pour plus d'informations : www.calia-analyse.com

A COLLER SUR LE FLACON



Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter : 06 69 94 94 60 ou vente@calia-analyse.com